

CHỨNG CHỈ PHÂN TÍCH
CERTIFICATE OF ANALYSIS

CHẤT ĐỐI CHIẾU (CĐC) : DIOSMIN FOR SYSTEM SUITABILITY
REFERENCE SUBSTANCE

SỐ LÔ : RM48926
LOT NO.

1. ĐẶC TÍNH/ CHARACTERISTIC


1.1. Mục đích sử dụng/ Purpose of use

Chất đối chiếu này được thiết lập để dùng trong chỉ tiêu tạp chất liên quan chuyên luận Diosmin theo Dược điển Anh, Dược điển Châu Âu phiên bản còn hiệu lực/ Established for use with the Diosmin monograph in British Pharmacopoeia, European Pharmacopoeia.

1.2. Hướng dẫn sử dụng/ Instruction for use

Vial chứa khoảng 0,5 mg Diosmin for system suitability. Sử dụng 0,5 ml dung môi thích hợp theo chuyên luận hòa tan toàn bộ lượng chất trong vial để được Reference solution (c) theo Dược điển Anh, Dược điển Châu Âu

1.3. Dữ liệu phân tích tham khảo/ Analytical information

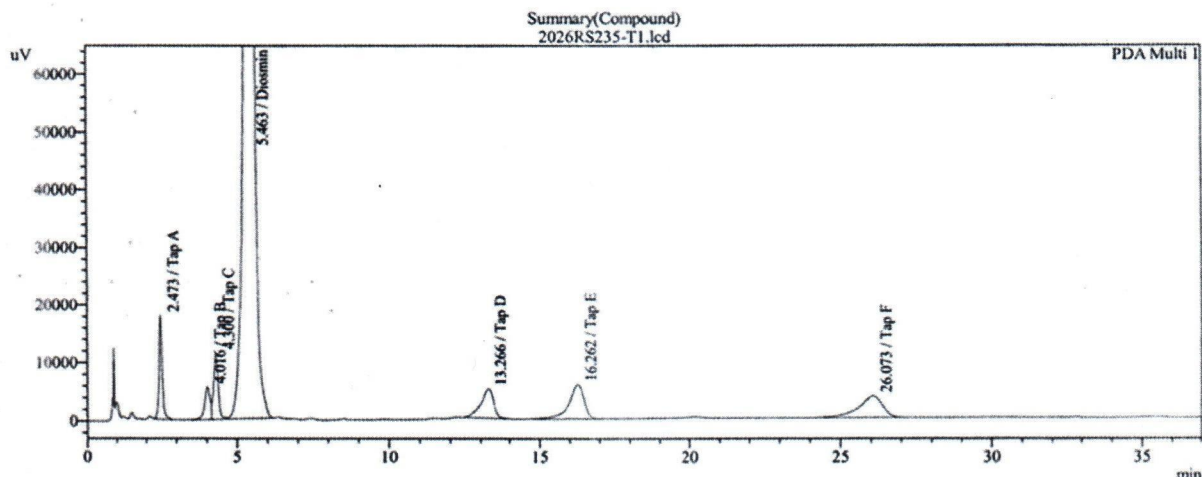

1.4. Liên kết chuẩn/ Traceability: Diosmin for system suitability EP CRS Batch 4

2. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN/ STORAGE CONDITION

Bảo quản $2 \div 8^{\circ}\text{C}$, tránh ánh sáng/ Store at $2 \div 8^{\circ}\text{C}$, protect from light.

3. ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN/ SHIPPING CONDITION

Điều kiện bình thường/ Shipment at ambient temperature for no controlled and no dangerous.

4. THÔNG TIN BAN HÀNH CCPT/ COA ISSUE'S INFORMATION

Nội dung	Ngày ban hành Issue date	Ngày đánh giá kế tiếp Next retest date	Ký tên Sign
Lần đầu/ 1 st issue	25/6/2026	30/6/2029	
Định kỳ 1/ 1 st periodical test			

LIÊN HỆ/ CONTACT:

- Địa chỉ/ Address : 200 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, Tp. HCM/ 200 Co Bac, Cau Ong Lanh Ward.
- Điện thoại/ Phone : 028 3838 9600 (số nội bộ/ Ext 24 or 38)
- Website/ Website : <http://www.vienkiemnghiem.gov.vn>
- Email/ Email : tlcc@vienkiemnghiem.gov.vn